Wöchnerinnenvorlagen Absorgyn

Die Außenschicht ist aus weichem Vliesstoff hergestellt.

Die Innenschicht stellt der Vliesstoff und die Zellulose-Saugeinlage dar, die hohe Saugfähigkeiten verleiht.

Die Folie zwischen dem Vliesstoff und der Zellulose-Saugeinlage bildet den Isolationsteil – sichert vor Durchnässen (in der Version mit Folie).

Anwendung:

- Die Produkte werden benutzt, um Sekrete zu absorbieren und die Hygiene und den Komfort von Frauen nach der Geburt oder nach gynäkologischen Eingriffen und Operationen zu erhöhen.
- Größe 35 cm x 11 cm – rechteckige, saugfähige Einlage für Frauen nach der Geburt und für Personen mit leichter Inkontinenz.
- Die sterilen Einlagen sind für die Aufnahme von Flüssigkeiten und Ausfluss nach der Geburt oder nach urologischen und gynäkologischen Eingriffen bestimmt.

Typen:

- steril und unsteril
- mit oder ohne Folie
- rechteckige und anatomische


Größen und Verpackung:

- erhältlich in Größen: 22 cm x 9 cm, 27 cm x 7,5 cm, 28 cm x 9 cm, 34 cm x 9 cm, 35 cm x 11 cm
- steril, verpackt je 10 Stk. oder je 5 Stk.
- unsteril, verpackt je 10 Stk., 15 Stk. (Größe 35 cm x 11 cm) und je 20 Stk. (Größe 22 cm x 9 cm)



Rectangular version / Rechteckige Version / Прямоугольная версия / Prostokątna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:

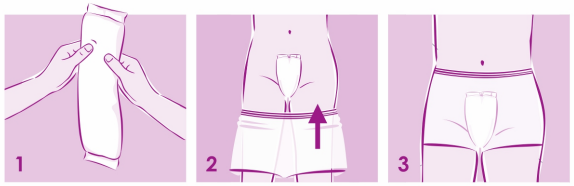

Towels should be changed regularly. / Die Vorlagen sollten regelmäßig gewechselt werden. / Прокладки следует регулярно менять. / Podkłady należy zmieniać regularnie.


The manufacturer recommends stabilisation with Seni Fix elastic supporting briefs. / Der Hersteller empfiehlt die Fixierung mit den elastischen Höschen von Seni Fix./ Производитель рекомендует использовать сетчатые трусики-фиксаторы Seni Fix для закрепления изделия. / Producent zaleca stabilizację za pomocą majtek siatkowych Seni Fix.





Anatomical version / Anatomische Version / Анатомическая версия / Anatomiczna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:

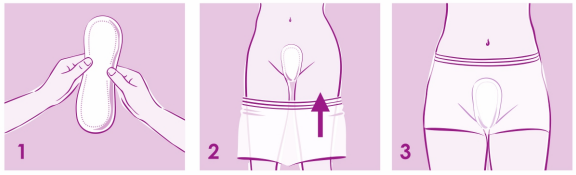

Towels should be changed regularly. / Die Vorlagen sollten regelmäßig gewechselt werden. / Прокладки следует регулярно менять. / Podkłady należy zmieniać regularnie.


The manufacturer recommends stabilisation with Seni Fix elastic supporting briefs. / Der Hersteller empfiehlt die Fixierung mit den elastischen Höschen von Seni Fix./ Производитель рекомендует использовать сетчатые трусики-фиксаторы Seni Fix для закрепления изделия. / Producent zaleca stabilizację za pomocą majtek siatkowych Seni Fix.

MD

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle TÜV Nord Polska Sp. z o.o. zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 2274

>>

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

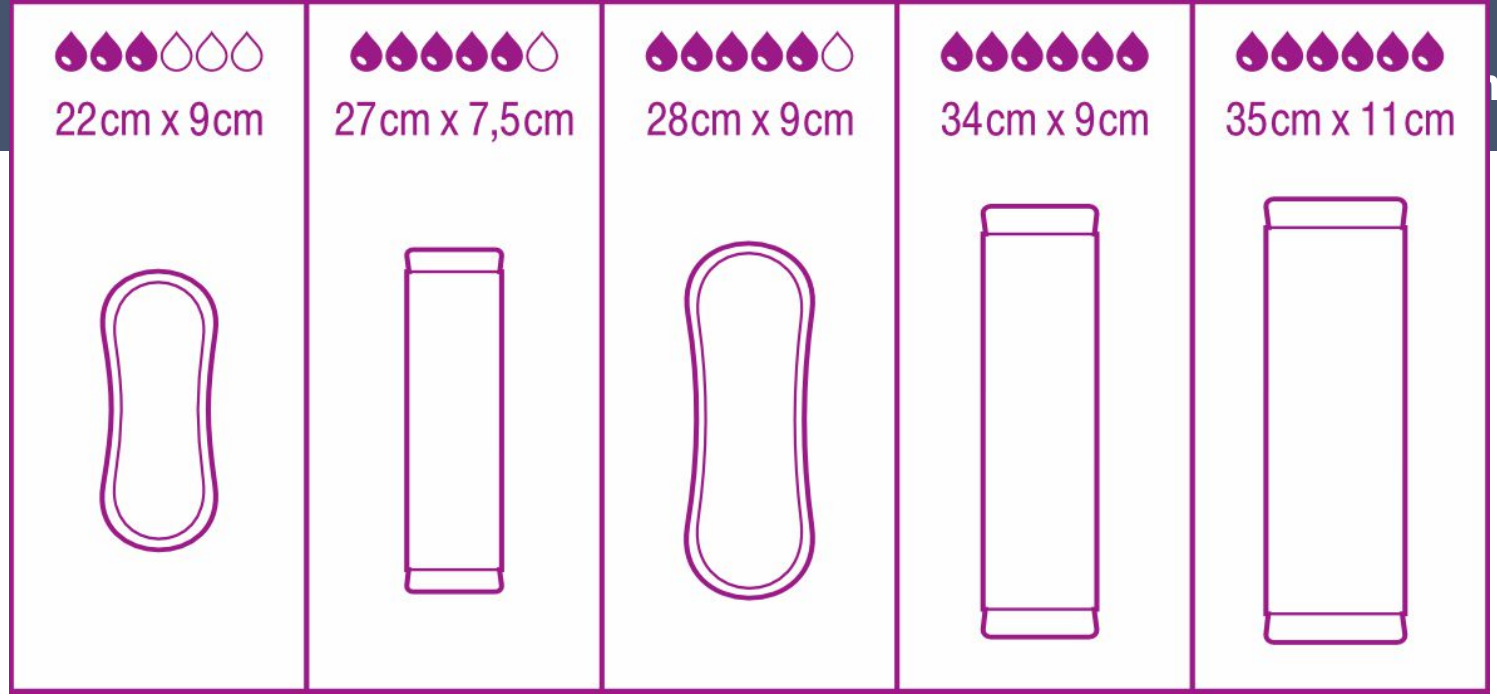

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026